S/Y/赛亚传感股份有限公司 Saiya Sensor Co., LTD

产品承认书 SPECIFICATION

客户名称 CUSTOMER	
产品名称 PRODUCTION	NDIR二氧化碳气体传感器模组
产品型号 MODEL	SY-CO2-24BMS
版本号 VERSION NO	A2.0

广东赛亚传感股份有限公司

电话:400-003-1626

网址: http://www.saiyasensor.com http://www.saia.cn www.saiacn.net

邮箱: saiya@ saiyasensor.com sensor@ saiyasensor.com





客户确认	审 核	编 制
CUSTOMER CONFIRMATION	CHECKED BY	PREPARED BY
	李柄	钟小易

电话: 400-003-1626 网址: http://www.saiyasensor.com

http://www.saia.cn www.saiacn.net 邮箱: sai ya@ sai yasensor.com

sensor@ sai yasensor.com

声明

本说明书版权属广东赛亚传感股份有限公司(以下称本公司) 所有, 未经书面许可, 本

说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内, 也不可以电子、翻拍、录音

等任何手段进行传播。

感谢您使用广东赛亚的系列产品。为使您更好地使用本公司产品,减少因使用不当造成

的产品故障, 使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户

不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件,本公司不承担由此造成的任

何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念,不断致力于产品改进和技术创新。因此,本公司保留任何

产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时,请确认其属于有效版本。同时,本公司鼓

励使用者根据其使用情况, 探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书,以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

广东赛亚传感股份有限公司


电话: 400-003-1626 网址: http://www.saiyasensor.com http://www.saia.cn_www.saiacn.net


邮箱:sai ya@ sai yasensor.com sensor@ sai yasensor.com



◆产品外观及尺寸







◆产品参数

参数	指标 指标
测量气体类型	CO_2
测量原理	NDIR
测量浓度范围	400ppm5000ppm
测量间隔	2秒
测量精度	± (50ppm + 5% of reading)
响应时间	T90时间为90秒
操作温度范围	0-50°C
操作湿度范围	0-90% RH non condensed
储存温度范围	-20°C60°C
尺寸	32.5X20X8.5mm (max dimensions)
供电要求	4.2V5.5V
电流消耗	300mA峰值电流,4mA 正常工作电流,13mA 平均工作电流
寿命	10+年
通讯接口	Uart /IIC
PWM Output	Period: 1004ms, Pulse: 2ms-1002ms (05000ppm)
Alarm Output	浓度>1000ppm 输出1, 浓度<800ppm输出0, 引脚为开漏输出模式, 不可吸入电流
自校准周期	上电后第一次自校准周期为24小时,之后自校准周期是7天

最大输入参数


参数	最小值	最大值	单位
极限环境储存温度	-40	85	°C
极限电源电压范围	-0.3	5.5	V
引脚最大输出电流	-25	+25	mA
引脚最大输入电流	-5	+5	uA
UART引脚最大加载电压	-0.3	3.5	V

电话: 400-003-1626 网址: http://www.saiyasensor.com http://www.saia.cn www.saiacn.net

邮箱: sai ya@ sai yasensor.com sensor@ sai yasensor.com



◆ 引脚图示

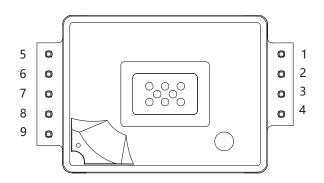

序号	定义
1	VIN: 4.2V5.5V
2	GND
3	Alarm-OC
4	PWM
5	VCC-Out:3.3V
6	Host-TX/IIC-SDA
7	Host-RX/IIC-SCL
8	R/T
9	bCAL-in

+ 引脚定义

引脚名称		
电源引脚	JTMP が出た	JIM RESEARCH
GND (Pin 2)	电源负端	
, ,	,	
VIN (Pin1)	电源正端	有防反接保护,输入电压范围:4.2V-5.5V
VCC-Out(Pin5)	传感器内部LDO输出,通常为3.3V±2%。 一般用于串口通讯电平转换。	输出电压:3.3V±2%,无过流保护 最大输出电流:6mA
通讯引脚		
Host-TX(Pin6) /IIC-SDA	主端系统的UART的TX引脚, 通常为客户MCU的TX,或者IIC功能的SDA	通常通讯电平为3.3V,内部有1K串联限流电阻。用作IIC功能时,引脚配置为开漏模式,使用时需要外接上拉电阻。
Host-RX(Pin7) /IIC-SCL	主端系统的UART的RX引脚, 通常为客户MCU的RX,或者IIC功能的SCL	通常通讯电平为3.3V,内部有1K串联限流电阻。用作IIC功能时,引脚配置为开漏模式,使用时需要外接上拉电阻。
功能引脚		
PWM (Pin4)	PWM功能,用于输出CO₂浓度。	引脚为推挽输出模式,输出PWM周期为 1004ms。
Alarm-OC(Pin3)	报警功能,引脚为开漏输出模式。当测量浓度 > 1000ppm时,该引脚输出高,当浓度 < 800ppm时,该引脚输出低。	引脚为开漏输出模式,不可直接驱动负 载,需外接上拉电阻。
R/T (Pin8)	这个引脚有两个功能: 1.作为RS485方向控制引脚。这个引脚为 开漏输出模式,可直接连接RS485芯片 的方向使能引脚,需外接上拉电阻。此 时模块Pin6和Pin7是UART功能。 2.UART/IIC功能选择引脚。这个引脚在 上电前接地(上电后再接地无效),模 块的Pin6和Pin7是IIC功能。	引脚上电时为带上拉输入模式,可悬空或者接地。作为RS485方向使能引脚时为开漏输出模式,需外接上拉电阻。
bCAL-in (Pin9)	手动校准控制引脚	引脚上电时为输入模式带上拉电阻

电话: 400-003-1626 网址: http:// www.saiyasensor.com http://www.saia.cn www.saiacn.net

邮箱:saiya@ saiyasensor.com sensor@ sai yasensor.com



◆ 校准功能

模块支持两种校准功能:

1.自校准功能

SY-C02-24BMS模块是精密光学模块,出厂后,由于运输,安装,焊接等各种原因,会引起模块的测 量产生一定的飘移,从而精度变差。模块内置了一套自校准算法,可以周期性自动修正测量误差,使模块 一直保持比较好的测量精度。模块自校准周期默认7天(168小时),可通过指令调整(24小时至720小时) 。为了使模块更快调整精度,模块在上电24小时内,会完成一次自校准,此后按照设置的周期,执行周期性 自校准。

为了确保校准后传感器的测量精度,请确保传感器在上电24小时内以及连续工作的7天内,其工作环 境中CO。的浓度至少有数小时能接近室外大气水平。

2.手动校准功能

除了自校准功能外,传感器还可以通过手动校准功能,快速恢复精度。

传感器的Pin9(bCAL-in),是手动校准的控制引脚。把这个引脚拉低2秒以上,传感器就能完成校准 。这个校准功能的参考浓度是户外大气中的CO。浓度,一般为400PPM左右。

使用这个功能,请先把传感器置于接近户外大气CO。浓度的环境中,例如比较通风的地方。在通电的 情况下,至少放置20分钟。然后拉低Pin9(bCAL-in)2秒以上,就可以完成校准。

此外,传感器还支持软件指令来校准。详见串口通讯指令章节。

◆报警功能

SY-C02-24BMS模块支持报警输出功能, 通过Alarm-OC引脚输出。当测量的CO,浓度 值 > 1000PPM时, Alarm-OC引脚输出高电 平。当测量的CO。浓度值<800PPM时, Alarm -OC引脚输出低电平。

注意, Alarm-OC引脚配置为开漏输出模 式,使用时需要外接上拉电阻。

如果模块发生错误, Alarm-OC引脚就会 一直保持高电平。

参考使用方法如右图

High <800ppm >1000ppm Low R2 470R VCC **I**VCC **VIN-5.0V** LED1 SY-C02-24BMS Alarm- OC 客户电路 GÑD GND

◆ 通讯协议

串口通讯

串口通讯的波特率为9600bps

串口通讯包定义:

1、协议格式

帧格式说明:

字段	长度	说明
帧头	2	固定为0x42,0x4D
指令字节	1	指令定义或传感器类型定义
命令字节	2	具体命令字
数据长度	2	大端
数据	n	大端
校验和	2	从帧头到数据最后一个字节的所有字节累加和

电话: 400-003-1626 网址: http://www.saiyasensor.com http://www.saia.cn www.saiacn.net

邮箱: sai ya@ sai yasensor.com sensor@ sai yasensor.com



以下协议说明适用于气体传感器系列,指令字节为: 0xA0。

命令字节说明

命令字	说明			
0x0001	设置气压参数(内部默认气压是1013.0hPa)			
0x0002	读当前设置的气压值			
0x0003	读气体浓度值			
0x0004	单点修正功能 (带参考浓度)			
0x0005	单点修正读取状态			
0x0006	禁止或者使能自校准			
0x0007	读取自校准状态			
0x0008	读取自校准周期 (小时数)			
0x0009	设置自校准周期 (小时数)			

2、基础控制协议

功能	名称	帧头	指令字节	命令字节	数据长度	数据	校验和
设置气	MCU发送	0x42 0x4d	0xA0	0x0001	0x00 0x02	大气压值范围是 7001100 (16bit整型)	校验和
压参数	模块返回	0x42 0x4d	0xA0	0x0001	0x00 0x00		校验和
读取	MCU发送	0x42 0x4d	0xA0	0x0002	0x00 0x00		校验和
当前气压值	模块返回	0x42 0x4d	0xA0	0x0002	0x00 0x02	大气压值(16bit整型)	校验和
读取	MCU发送	0x42 0x4d	0xA0	0x0003	0x00 0x00		校验和
当前浓度值	模块返回	0x42 0x4d	0xA0	0x0003	0x00 0x05	气体浓度值 (32bit整型) 和 数据有效标识(8bit) 0x00:有 效; 0xFF:数据不可用;	校验和
单点修 正功能	MCU发送	0x42 0x4d	0xA0	0x0004	0x00 0x04	参考浓度的范围是 4005000 (32bit整型)	校验和
(帯参 考 浓 度)	模块返回	0x42 0x4d	0xA0	0x0004	0x00 0x01	0x01:表示校准开始 0xff:表示校准错误	校验和
读取单	MCU发送	0x42 0x4d	0xA0	0x0005	0x00 0x00		校验和
点修正 状态	模块返回	0x42 0x4d	0xA0	0x0005	0x00 0x01	0x00:表示校准完成 0x01:表示仍在校准	校验和
使能或 者禁止	MCU发送	0x42 0x4d	0xA0	0x0006	0x00 0x01	0x00:使能自校准 0xff:禁止自校准	校验和
自校准	模块返回	0x42 0x4d	0xA0	0x0006	0x00 0x00		校验和
读取	MCU发送	0x42 0x4d	0xA0	0x0007	0x00 0x00		校验和
自 校准状态	模块返回	0x42 0x4d	0xA0	0x0007	0x00 0x01	0x00:使能自校准 0xff:禁止自校准	校验和
读取	MCU发送	0x42 0x4d	0xA0	0x0008	0x00 0x00		校验和
自 校 准周期	模块返回	0x42 0x4d	0xA0	0x0008	0x00 0x02	自校准周期范围: 24720h	校验和
\	MCU发送	0x42 0x4d	0xA0	0x0009	0x00 0x02	自校准周期范围: 24720h	校验和
设 宣 校 准周期	模块返回	0x42 0x4d	0xA0	0x0009	0x00 0x01	00:正确操作; 01:输入的数据 小于24h, 不予接受; 02:输入 的数据大于720h, 不予接受	校验和

电话: 400-003-1626 网址: http://www.saiyasensor.com http://www.saia.cn www.saiacn.net

邮箱: sai ya@ sai yasensor.com sensor@ sai yasensor.com



3、应用示例

①设置气压参数

发送: 0x42 0x4D 0xA0 0x00 0x01 0x00 0x02 0x03 0xF5 0x02 0x2A

Device Phase	Data	Description	Cmd.Phase.Ofs(rep)
43 OUT	42 4d a0 00 01 00 02 03 f5 02 2a	BM*	1.1.0
43 IN	42 4d a0 00 01 00 00 01 30	BM0	2.1.0

0x03F5为1013的十六进制;

②读取当前气压值

发送: 0x42 0x4D 0xA0 0x00 0x02 0x00 0x00 0x01 0x31

Device Ph	nase	Data			Description	Cmd.Phase.Ofs(rep)
43 OU			02 00 00 01		BM1	1.1.0
43 IN	N I	42 4d a0 00	02 00 02 03	f5 02 2Ъ	BM+	2.1.0

③读取气体浓度值

发送: 0x42 0x4D 0xA0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x01 0x32

数据有效位为0xff,数据不可用:

Device	Phase	Data	Description	Cmd.Phase.Ofs(rep)
43 43	OUT	42 4d a0 00 03 00 00 01 32 42 4d a0 00 03 00 05 00 00 00 00 ff 02 36	BM2 BM 6	1.1.0
-10		12 12 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	Dii	2.1.0

◆ⅡC指令解析

模块工作于IIC的从机模式,可以与外部的MCU相连,模块内部含上拉电阻。

模块器件从地址是: 0x32 (7位地址)

模块的写操作地址是: 0x64 模块的读操作地址是: 0x65

主机发送时序:

- 1.发送开始信号
- 2.发送地址写(从机地址+R/W=0x64)和检查应答
- 3.发送读命令(0x03)和检查应答
- 4.发送停止信号
- 5.发送开始信号
- 6.发送地址读(从机地址+R/W(1)=0x65)和检查应答
- 7.从模块读3个字节并发送应答
- 8.发送停止信号

收到的3字节数据描述如下:

CO₂浓度		数据有效字节
浓度高字节	浓度低字节	0x00/0xFF

注意:

CO2浓度 = CO2浓度中的高字节*256 + 低浓度字节 数据有效字节,0x00表示数据有效,0xff表示数据无效

电话:400-003-1626 网址:http://www.saiyasensor.com http://www.saia.cn www.saiacn.net

邮箱: sai ya@ sai yasensor.com sensor@ sai yasensor.com



◆ PWM功能详解

PWM的周期是1004ms 起始阶段高电平输出2ms 中部周期1000ms 结束阶段低电平输出2ms 通过PWM获得当前CO₂浓度值的计算公式: Cppm = 5000* (TH-2ms) / (TH+TL-4ms)Cppm为计算得到的CO₂浓度值,单位是ppm Th为一个输出周期中输出为高电平的时间 TI为一个输出周期中输出为低电平的时间

